


PRUEFBERICHT

Kunde:		Prüfer:	Nico Christensen
Benennung:	VENT U. FEED ADAPTER / ACT4	Messung vom:	28.02.2020
Bezeichnung 1:	D005-82860-109W6700-82A99 / POS.102	Protokoll-Nr.:	200228-A531.6
Bezeichnung 2:	ID.Nr.: 95159390	Messgerät:	Mitutoyo SJ-410 Nr.:001411705
Bezeichnung 3:	EQ.Nr.: 20222769 / Auftrag: 37020	Kalibrierung:	mit Raunormal Serial No.: 348991705

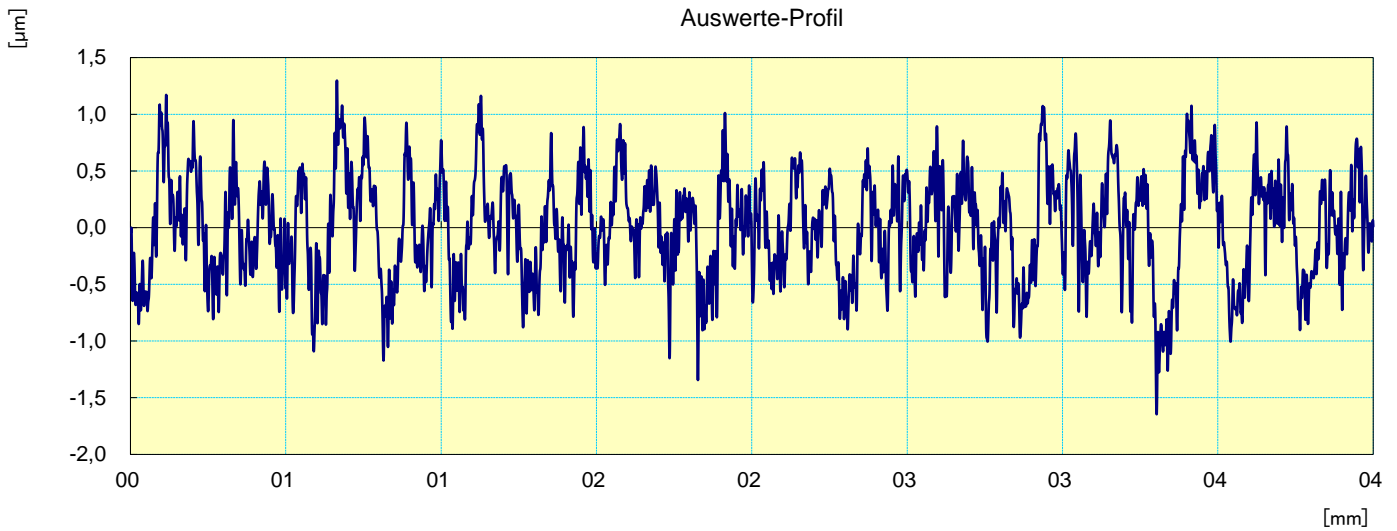

Norm	ISO 1997	N	5
Profil	R	Cut-Off	0.8mm
λ_s	2.5µm	Filter	GAUSS
Ra	0.372 µm		
Rz	2.374 µm		

 Datum / Unterschrift

